



# INSTYTUT PROBLEMÓW JĄDROWYCH

## im. Andrzeja Sołtana

### DZIAŁ SZKOLENIA I DORADZTWA

sekretariat: tel. 0 22 718 0612, fax 0 22 779 3481, e-mail: dsid@ipj.gov.pl •  
prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński e-mail: ludwik@ipj.gov.pl •  
mgr Ewa Droste e-mail: droste@ipj.gov.pl • mgr inż. Łukasz Adamowski e-mail: l.adamowski@ipj.gov.pl •  
Robert Wołkiewicz e-mail: r.wolkiewicz@ipj.gov.pl

|   |   |
|---|---|
| ĆWICZENIE                                     | LABORATORIUM FIZYKI ATOMOWEJ I JĄDROWEJ   |
| 1   | <b>Zastosowanie pojęć analizy statystycznej do opracowania pomiarów promieniowania jonizującego</b> |
| Data pomiaru: .....                           |   |
| Imię i nazwisko studenta/ ucznia: .....       |   |
| Wydział, kierunek, rok studiów/ Szkoła: ..... |   |

## 1. CEL ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest sprawdzenie, czy rozrzut liczby cząstek (z rozpadu promieniotwórczego danego izotopu) zarejestrowanych w detektorze, ma charakter statystyczny i jakie są cechy otrzymanego rozkładu statystycznego.

## 2. UKŁAD DOŚWIADCZALNY

Zestaw ćwiczeniowy (rys. 1) stanowią:

- detektor promieniowania jonizującego (np. sonda scyntylacyjna NaI(Tl) lub detektor G-M),
- źródło promieniotwórcze,
- domek osłonowy,
- zasilacz wysokiego napięcia ZWN-21 (rys. 2),
- wzmacniacz impulsów WL-21,
- dyskryminator amplitudy impulsów A-21,
- przelicznik impulsów P-44 (rys. 2).

## 3. WSTĘP TEORETYCZNY

Często okazuje się, że obserwowane przez nas procesy mają charakter statystyczny. To znaczy, że nie mamy pewności, że po zdarzeniu A zawsze zachodzi zdarzenie B, możemy tylko określić średnie prawdopodobieństwo tego, że po A zdarza się B. Takimi wielkościami, jak mówimy - statystycznymi - są np.:

- liczba cząstek z rozpadu promieniotwórczego określonego izotopu, zarejestrowana przez przelicznik w danym odstępie czasu,
- liczba jonizacji atomów ośrodka przy przejściu przez cząstkę jonizującą jednostki długości drogi w materiale detektora.


Celem ćwiczenia jest sprawdzenie, jak zmienia się rozrzut liczby zliczeń cząstek dochodzących do detektora w czasie 1 sekundy, gdy zmieniamy czas trwania pojedynczego pomiaru  $t_p$ . W tym celu wykonujemy:

- 50 pomiarów z  $t_p = 1$  s,
- 20 pomiarów z  $t_p = 10$  s,
- 10 pomiarów z  $t_p = 100$  s,

a wszystkie wyniki zapisujemy w tabelach (jedna dla każdej serii pomiarowej).

Opracowując wyniki każdej serii pomiarowej należy:

1. sporządzić *histogram*, tj. wykres pokazujący ile razy otrzymaliśmy liczby z wybranego przez nas przedziału zliczeń. Na przykład, możemy przyjąć, że interesuje nas liczba przypadków pojawienia

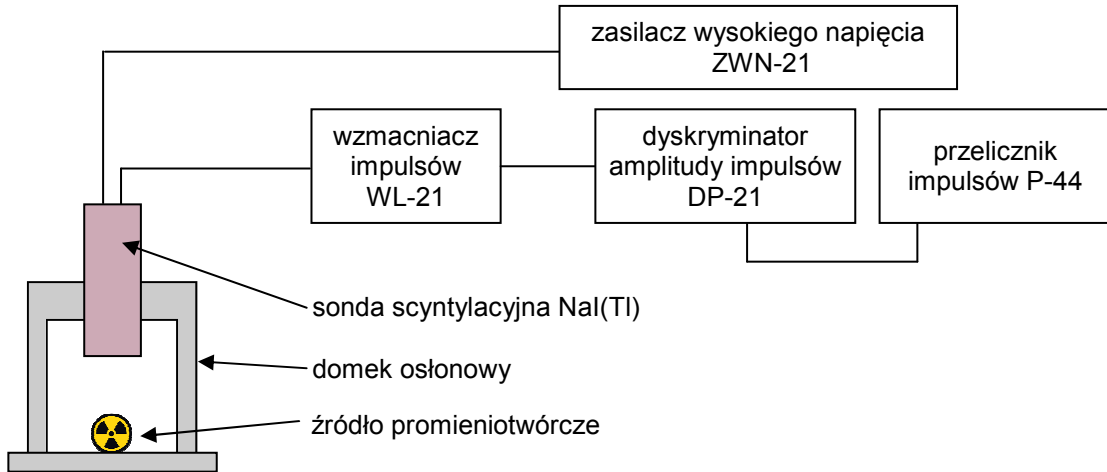

Rys. 1

się zliczeń pomiędzy 0 a 9, następnie 10-19, 20-29, itd. Histogram pokazuje nam, jaka jest częstość występowania określonej liczby zliczeń;

- obliczyć na podstawie histogramu średnią liczbę zliczeń  $\bar{N}$  (na sekundę) w danej serii:

$$\bar{N} = \frac{\sum k_j n_j}{L} \quad (1)$$

gdzie  $k_j$  - częstość pojawienia się liczby  $n_j$  w  $j$ -tym przedziale histogramu,  $L$  - całkowita liczba pomiarów;

- obliczyć tzw. *średnie odchylenie standardowe*  $\sigma(N)$ :

$$\sigma^2(N) = \frac{\sum k_j (n_j - \bar{N})^2}{L - 1} \quad (2)$$

Interpretacja takiego odchylenia jest następująca: w przedziale  $\pm\sigma$  wokół średniej wartości  $\bar{N}$  powinno się znaleźć około 68% wyników. Wielkość  $\sigma$  utożsamiamy często z niepewnością wyniku pomiarowego dla pojedynczego zliczenia. Niepewność wartości średniej arytmetycznej,  $\bar{N}$ :

$$\sigma(\bar{N}) = \frac{\sigma(N)}{\sqrt{L}} \quad (3)$$

Być może takie rozumienie niepewności pomiaru wydaje się dziwne, ale jest ono konsekwencją pewnej umowy uczonych – umowy opartej o prawa rozkładów statystycznych rządzących wynikami pomiarowymi.

**Można wykazać, że dla dużej liczby pomiarów,  $L$ ,  $\sigma^2 \approx \bar{N}$ , możemy więc posługiwać się przybliżeniem, zgodnie z którym otrzymanej liczbie  $N$  zliczeń przypisujemy niepewność wynoszącą  $\sqrt{N}$ .**

Więcej w ramce „Rozkład normalny” na następnej stronie.



Rys. 2 (zasilacz ZWN-21, przelicznik P-44)



## ROZKŁAD NORMALNY

Wielokrotne powtarzanie pomiaru pozwala na określenie rozkładu prawdopodobieństwa,  $P(N)$ , podającego, że w danym odstępie czasu zaistnieje  $N$  zdarzeń, przy średniej częstości  $m$  ich występowania.

Jeżeli spełnione są warunki:

- niezależność obserwowanych zdarzeń - pojawienie się oczekiwanego zdarzenia (np.  $N$  zliczeń na sekundę) jest niezależne od poprzednich zdarzeń tego typu (w tym zadaniu - poprzednich zliczeń na sekundę),
- prawdopodobieństwo pojawienia się jakiegokolwiek zdarzenia w czasie  $\Delta t$  jest proporcjonalne do długości tego odcinka czasu,

to w praktyce laboratoryjnej do opisu rozkładu prawdopodobieństwa posługujemy się zazwyczaj *rozkładem Gaussa*, zwanym niekiedy *rozkładem normalnym*, opisywanym przez funkcję:

$$P(N) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(N - m)^2}{2\sigma^2}\right)$$

a z danych doświadczalnych wyznaczamy oba parametry tej funkcji: wartość średnią  $m$ , oraz parametr  $\sigma^2$  zwany „wariancją” rozkładu.

Parametr  $\sigma$  [litera grecka „sigma”], zwany często „odchyleniem standardowym” ma taki sens, że:

- w przedziale wartości  $\langle m - \sigma, m + \sigma \rangle$  mieści się ~68,3 % wyników pomiarów,
- w przedziale wartości  $\langle m - 2\sigma, m + 2\sigma \rangle$  mieści się ~95,6 % wyników pomiarów,
- w przedziale wartości  $\langle m - 3\sigma, m + 3\sigma \rangle$  mieści się ~99,7 % wyników pomiarów.

## 4. PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA

### UWAGA: wszelkie operacje ze źródłami promieniowania przeprowadza obsługa laboratorium!

A) Przed włączeniem zasilacza należy sprawdzić i ewentualnie skorygować ustawienie elementów regulacyjnych aparatury elektronicznej:

- zasilacz ZWN-21:
  - wciśnięty przycisk „0 – 1000 V”,
  - potencjometr „HT CONTROL” na „0,00” (gałka regulatora przekręcona w lewe skrajne położenie);
- dyskryminator DP-21:
  - wciśnięty przycisk „+”,
  - potencjometr „THRESHOLD” ustawiony na wartości <sup>1</sup>;
- wzmacniacz WL-21:
  - potencjometr „x ↔ x” ustawiony na wartości „0,0”,
  - przycisk „GAIN” wciśnięty na ,
  - przycisk „SHAPING” wciśnięty na  μs;
- Przelicznik impulsów P-44:
  - wciśnięty przycisk „PRESET TIME”,
  - wciśnięty przycisk „MULTIPLIER”: x,
  - wciśnięty przycisk „SECONDS” odpowiednio na  $t_p = 1$  s, 10 s, 100 s.

B) Włączyć zasilanie aparatury:

- w tym celu należy we wszystkich blokach układu pomiarowego wcisnąć przyciski z napisem „POWER”;
- następnie w zasilaczu ZWN-21 przekręcić gałkę potencjometru na wartość  (w prawo, aż do oporu mechanicznego).

C) Dokonać 3 pomiarów *biegu własnego układu* ( $t_{la}$ )  $n_t$  dla  $t_p = 100$  s. Otrzymane wyniki zapisać w tabeli 1. Obliczyć średnią wartość  $\bar{N}_t$  (na jedną sekundę).

D) Po wykonaniu powyższych czynności do domku osłonowego zostanie włożone źródło promieniowania, a domek zostanie zamknięty.

<sup>1</sup> szczegółowe ustawienia aparatury podane zostaną w trakcie wykonywania ćwiczenia

E) Wykonać serię 50 pomiarów liczby impulsów przy czasie pomiaru  $t_p = 1$  s. W tym celu w przeliczniku P-44 nacisnąć przycisk „START – STOP”. Zaświeci się sygnalizacja „GATE”, a po nastawionym czasie  $t_p$  zgaśnie. Wyświetlony wynik pomiaru należy zapisać w tabeli pomiarowej (tabela 2), nacisnąć przycisk „RESET” i rozpocząć następny pomiar.

F) W przeliczniku P-44 wcisnąć przycisk „SECONDS” =  $10^1$  i wykonać serię 20 pomiarów podobnie jak w punkcie E. Wyniki zapisać w tabeli 3.

G) W przeliczniku P-44 wcisnąć przycisk „SECONDS” =  $10^2$  i wykonać serię 10 pomiarów podobnie jak w punktach E i F. Wyniki zapisać w tabeli 4.

## 5. OPRACOWANIE WYNIKÓW

A) Rysujemy histogramy dla wszystkich trzech serii pomiarowych, czyli obrazujemy częstość pojawienia się danej liczby zliczeń.

B) Obliczamy wartości średnie dla każdego histogramu  $\bar{N}_1$ ,  $\bar{N}_{10}$  oraz  $\bar{N}_{100}$ , czyli średnią liczbę zliczeń na 1 sekundę w pomiarach trwających odpowiednio 1 s, 10 s, 100 s. Zaznaczamy na każdym z trzech histogramów położenia tych średnich.

C) Posługując się kalkulatorem obliczamy wartości odchylenia standardowego  $\sigma$  dla trzech serii pomiarów, zaznaczamy na wykresie przedziały  $\langle \bar{N} - \sigma, \bar{N} + \sigma \rangle$ .

D) Oceniamy, w procentach, ułamek  $\sigma/\bar{N}$ , dla każdej z trzech serii pomiarowych.

E) Sprawdzamy relację  $\sigma^2 \approx \bar{N}$ .

F) Omówienie wyników.

Na końcu spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: **czy lepiej zliczać impulsy 100 razy po 5 sekund czy 10 razy po 50 sekund?**

TABELA 1

| Lp.   | Liczba zliczeń biegu własnego układu (tła)<br>$n_t$ | Odchylenie od wartości średniej<br>$\Delta_j = n_t - \bar{N}$ |
|---|---|---|
| 1   |   |   |
| 2   |   |   |
| 3   |   |   |
| suma  | $N_{t\bar{a}} = \sum n_t =$                         | $\sum \Delta_j =$   |
| wartość średnia $\bar{N}_t = (\sum n_t)/3 =$  |   |   |
| statystyczna niepewność pojedynczego pomiaru $\sigma = (\sum \Delta_j^2/2)^{1/2} =$ |   |   |
| statystyczna niepewność wartości średniej $\sigma/3 =$                              |   |   |

**TABELA 2**

| Lp. | Obserwowana liczba zliczeń<br>$p_j$ | Liczba zliczeń po odjęciu tła<br>$n_j = p_j - \bar{N}_t$ | Odchylenie $\Delta$ od wartości średniej<br>$\Delta_j = n_j - \bar{N}$ | $(\Delta_j)^2$ |
|-----|-------------------------------------|--|--|----------------|
| 1   |                                     |  |  |                |
| 2   |                                     |  |  |                |
| 3   |                                     |  |  |                |
| 4   |                                     |  |  |                |
| 5   |                                     |  |  |                |
| 6   |                                     |  |  |                |
| 7   |                                     |  |  |                |
| 8   |                                     |  |  |                |
| 9   |                                     |  |  |                |
| 10  |                                     |  |  |                |
| 11  |                                     |  |  |                |
| 12  |                                     |  |  |                |
| 13  |                                     |  |  |                |
| 14  |                                     |  |  |                |
| 15  |                                     |  |  |                |
| 16  |                                     |  |  |                |
| 17  |                                     |  |  |                |
| 18  |                                     |  |  |                |
| 19  |                                     |  |  |                |
| 20  |                                     |  |  |                |
| 21  |                                     |  |  |                |
| 22  |                                     |  |  |                |
| 23  |                                     |  |  |                |
| 24  |                                     |  |  |                |
| 25  |                                     |  |  |                |
| 26  |                                     |  |  |                |
| 27  |                                     |  |  |                |
| 28  |                                     |  |  |                |
| 29  |                                     |  |  |                |
| 30  |                                     |  |  |                |
| 31  |                                     |  |  |                |
| 32  |                                     |  |  |                |
| 33  |                                     |  |  |                |

|  |  |                  |                   |                       |
|--|--|------------------|-------------------|-----------------------|
| 34   |  |                  |                   |                       |
| 35   |  |                  |                   |                       |
| 36   |  |                  |                   |                       |
| 37   |  |                  |                   |                       |
| 38   |  |                  |                   |                       |
| 39   |  |                  |                   |                       |
| 40   |  |                  |                   |                       |
| 41   |  |                  |                   |                       |
| 42   |  |                  |                   |                       |
| 43   |  |                  |                   |                       |
| 44   |  |                  |                   |                       |
| 45   |  |                  |                   |                       |
| 46   |  |                  |                   |                       |
| 47   |  |                  |                   |                       |
| 48   |  |                  |                   |                       |
| 49   |  |                  |                   |                       |
| 50   |  |                  |                   |                       |
| suma:  |  | $N = \sum n_j =$ | $\sum \Delta_j =$ | $\sum (\Delta_j)^2 =$ |
| wartość średnia $\bar{N} = (\sum n_j)/50 =$                          |  |                  |                   |                       |
| średnie odchylenie standardowe $\sigma^2 = \sum (\Delta_j)^2 / 49 =$ |  |                  |                   |                       |
| statystyczna niepewność pojedynczego pomiaru $\sigma(n) =$           |  |                  |                   |                       |
| statystyczna niepewność średniej z 50 pomiarów $\sigma(\bar{N}) =$   |  |                  |                   |                       |

**TABELA 3**

| Lp. | Obserwowana liczba zliczeń<br>$p_j$ | Liczba zliczeń po odjęciu tła<br>$n_j = p_j - \bar{N}_t$ | Odchylenie $\Delta$ od wartości średniej<br>$\Delta_j = n_j - \bar{N}$ | $(\Delta_j)^2$ |
|-----|-------------------------------------|--|--|----------------|
| 1   |                                     |  |  |                |
| 2   |                                     |  |  |                |
| 3   |                                     |  |  |                |
| 4   |                                     |  |  |                |
| 5   |                                     |  |  |                |
| 6   |                                     |  |  |                |
| 7   |                                     |  |  |                |
| 8   |                                     |  |  |                |
| 9   |                                     |  |  |                |
| 10  |                                     |  |  |                |

|  |  |                  |                   |                       |
|--|--|------------------|-------------------|-----------------------|
| 11   |  |                  |                   |                       |
| 12   |  |                  |                   |                       |
| 13   |  |                  |                   |                       |
| 14   |  |                  |                   |                       |
| 15   |  |                  |                   |                       |
| 16   |  |                  |                   |                       |
| 17   |  |                  |                   |                       |
| 18   |  |                  |                   |                       |
| 19   |  |                  |                   |                       |
| 20   |  |                  |                   |                       |
| suma:  |  | $N = \sum n_j =$ | $\sum \Delta_j =$ | $\sum (\Delta_j)^2 =$ |
| wartość średnia $\bar{N} = (\sum n_j)/20 =$                          |  |                  |                   |                       |
| średnie odchylenie standardowe $\sigma^2 = \sum (\Delta_j)^2 / 19 =$ |  |                  |                   |                       |
| statystyczna niepewność pojedynczego pomiaru $\sigma(n) =$           |  |                  |                   |                       |
| statystyczna niepewność średniej z 20 pomiarów $\sigma(\bar{N}) =$   |  |                  |                   |                       |

**TABELA 4**

| Lp.   | Obserwowana liczba zliczeń<br>$p_j$ | Liczba zliczeń po odjęciu tła<br>$n_j = p_j - \bar{N}_t$ | Odchylenie $\Delta$ od wartości średniej<br>$\Delta_j = n_j - \bar{N}$ | $(\Delta_j)^2$        |
|---|-------------------------------------|--|--|-----------------------|
| 1   |                                     |  |  |                       |
| 2   |                                     |  |  |                       |
| 3   |                                     |  |  |                       |
| 4   |                                     |  |  |                       |
| 5   |                                     |  |  |                       |
| 6   |                                     |  |  |                       |
| 7   |                                     |  |  |                       |
| 8   |                                     |  |  |                       |
| 9   |                                     |  |  |                       |
| 10  |                                     |  |  |                       |
| suma:   |                                     | $N = \sum n_j =$   | $\sum \Delta_j =$  | $\sum (\Delta_j)^2 =$ |
| wartość średnia $\bar{N} = (\sum n_j)/10 =$                         |                                     |  |  |                       |
| średnie odchylenie standardowe $\sigma^2 = \sum (\Delta_j)^2 / 9 =$ |                                     |  |  |                       |
| statystyczna niepewność pojedynczego pomiaru $\sigma(n) =$          |                                     |  |  |                       |
| statystyczna niepewność średniej z 10 pomiarów $\sigma(\bar{N}) =$  |                                     |  |  |                       |